



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

CÓDIGO: PD-GAA-28

VERSIÓN: 01

PAGINA: 1 de 3

PROCESO GESTIÓN DE APOYO A LA ACADEMIA

FECHA: 14/12/2011

PROCEDIMIENTO PARA ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO DE AGUA

VIGENCIA: 2011

1. Objeto: Determinar la calidad el agua de consumo humano y animal para evitar propagación de infecciones gastrointestinales.

2. Alcance: Con este análisis se califica y controla la calidad de agua para el consumo animal y humano

3. Referencias Normativas: Decreto 2115 del 2007

4. Definiciones:

- **Usuario externo:** Plantas de expendio de aguas, comunidad en general
- **Usuario interno:** Estudiantes, Docentes

5. Condiciones Generales:

Para realizar este procedimiento es necesario:

- Reclamar el recipiente estéril en el laboratorio y solicitar las condiciones para la toma de la muestra.
- Llenar el formato de solicitud de la muestra.
- Presentar el recibo de pago de la oficina de pagaduría, si es usuario externo.
- Si es usuario interno debe tener el visto bueno del profesor de la asignatura, del director del proyecto o del director de la Escuela.
- Horario de recepción de muestras de lunes a jueves de 8:00 a 11:00 y de 2:00 a 4:00 p.m.
- Plazo de entrega: 24 horas.

6. Contenido:

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	PRODUCTO
1.	Solicitar el servicio en el Laboratorio	Usuarios Externos Usuarios Internos	FO-GAA-46 Recepción muestras laboratorio de microbiología.
2.	Reclamar en el Laboratorio el frasco estéril con las recomendaciones para la toma de la Muestra.	Usuarios Externos Usuarios Internos	

ELABORO: Luz Adíela Gómez. Alejandra Carrión J.	REVISÓ: Dumar Alexander Jaramillo H.	APROBÓ: Claudio Javier Criollo Ramírez
CARGO: Coordinadora de Lab. -- Auxiliar Lab.	CARGO: Director Escuela de Ciencias Animales.	CARGO: Representante de la Alta Dirección
FIRMA	FIRMA	FIRMA

Al imprimir este documento se convierte en copia no controlada del SIG y su uso es responsabilidad directa del usuario



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

CÓDIGO: PD-GAA-28

VERSIÓN: 01

PAGINA: 2 de 3

PROCESO GESTIÓN DE APOYO A LA ACADEMIA


FECHA: 14/12/2011


PROCEDIMIENTO PARA ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO DE AGUA

VIGENCIA: 2011

3.	Realizar el Pago del servicio en la oficina de Pagaduría.	Usuarios Externos	Recibo de Pago
4.	Recepcionar la muestra por parte del Laboratorio	Coordinadora Laboratorio o Auxiliar	
5.	Procesar la Muestra en el laboratorio	Coordinadora Laboratorio o Auxiliar	
6.	Lectura de Resultados	Bacterióloga coordinadora del Laboratorio	
7.	Entrega de resultados	Coordinadora Laboratorio o Auxiliar	FO-GAA-49 Resultado análisis microbiológico de agua.

7. Flujograma:

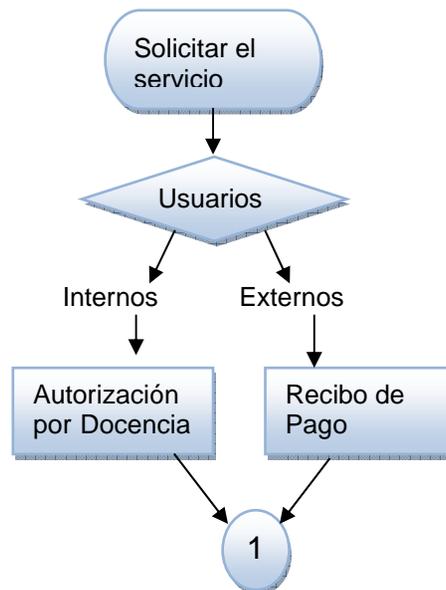

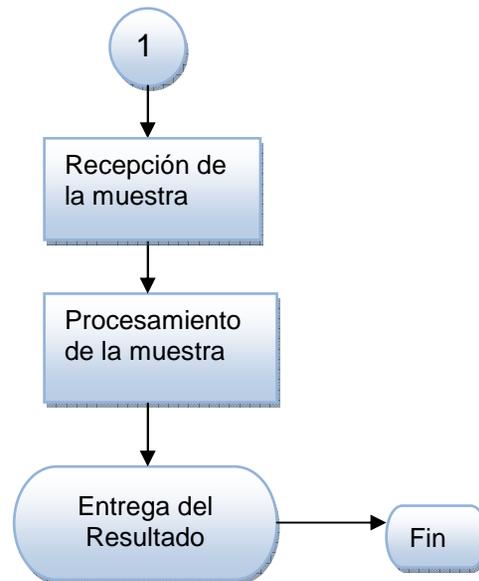

8. Documentos de Referencia:

- Guía de práctica de Laboratorio No 007 del Laboratorio de Microbiología.
- [FO-GAA-46](#) Recepción muestras laboratorio de microbiología.
- [FO-GAA-49](#) Resultado análisis microbiológico de agua.

9. Historial de Cambios:

Fecha	Cambio	Nueva versión
20/11/2011	Documento nuevo	01